




蓋を外す

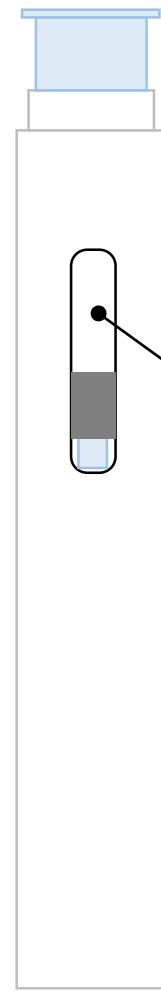


まだ針は隠れている

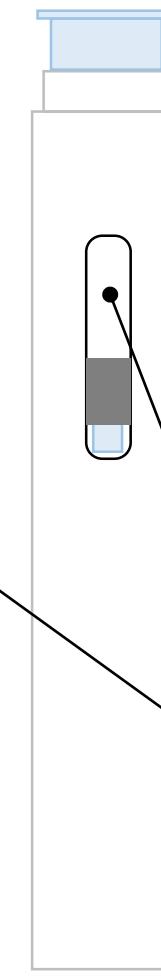

局部をささせてカチッと音  
がするまで押しつける

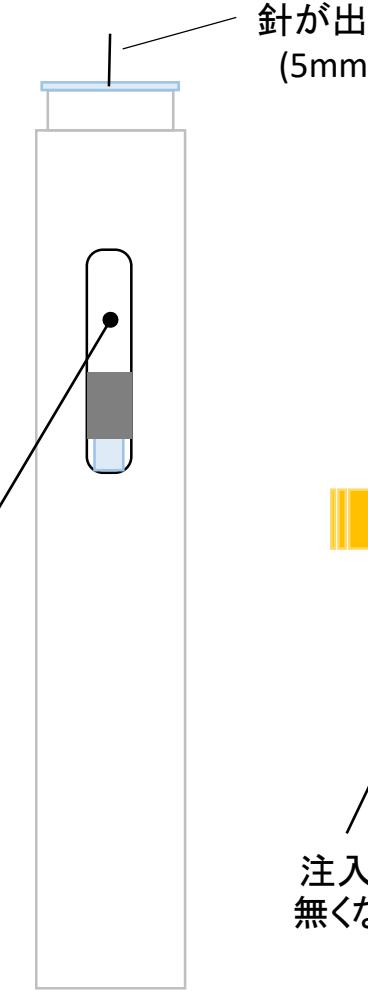

注入が終了したら、このよ  
うに自動で元の高さに戻る

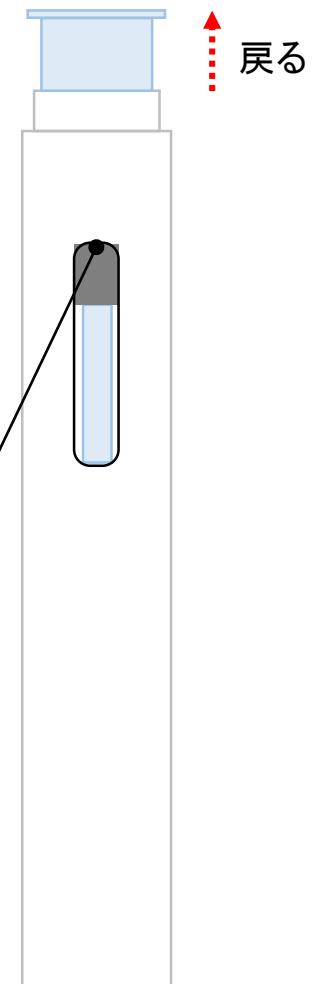


薬剤

注入後  
無くなる


針が出る  
(5mm)

戻る

上皮静脈を避け、注射方向10時 or 10分方向より  
海綿体中心(動脈)を避けて注入

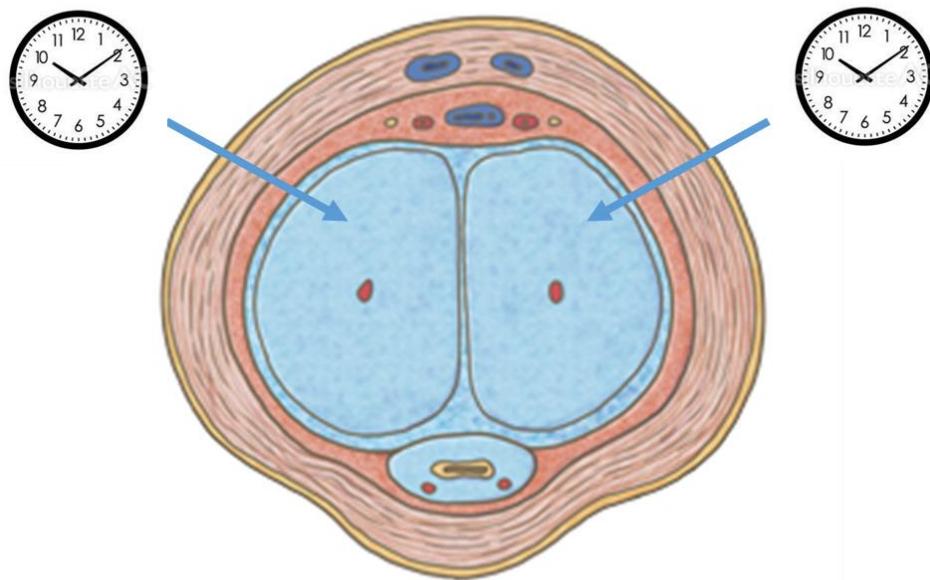

静脈および頭部から2cm以上避ける





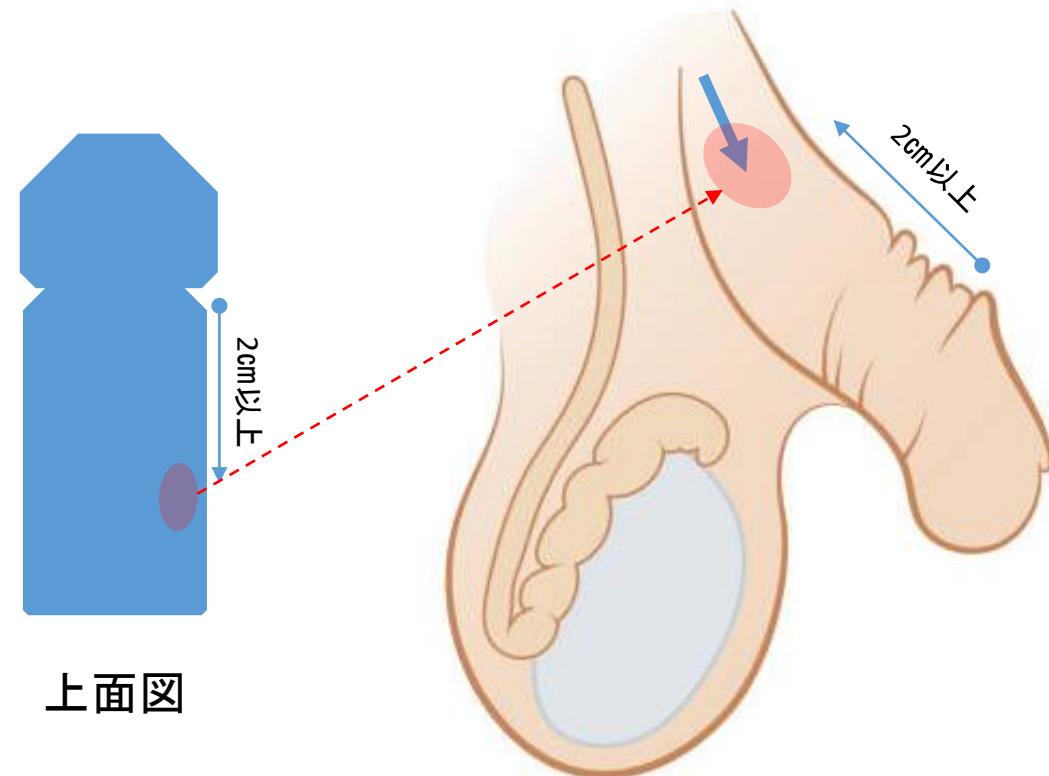


側面図

10時方向



キャップを外し角度(10時方向)を維持したまま近づける

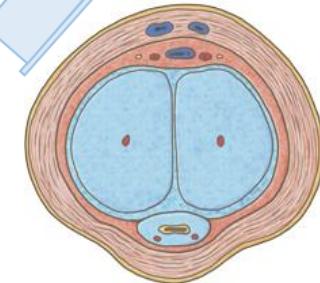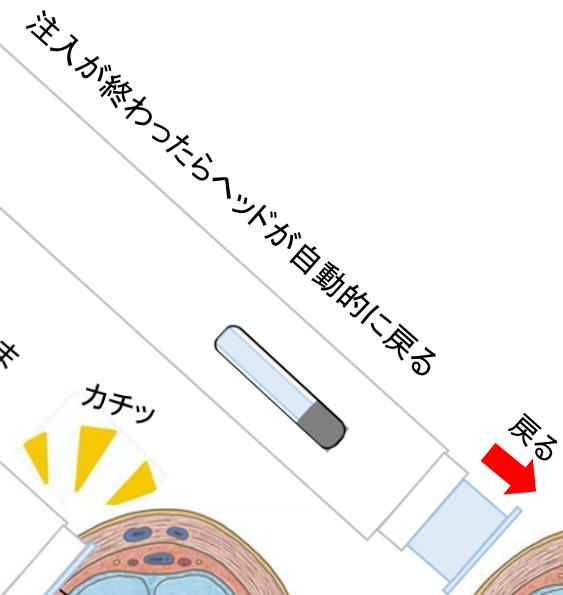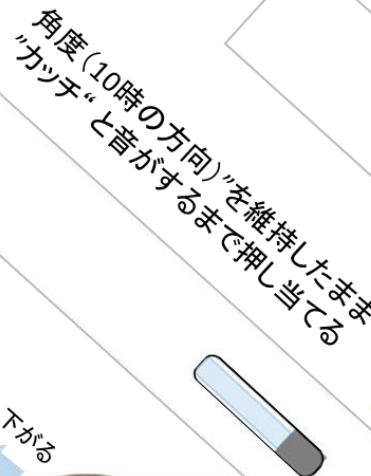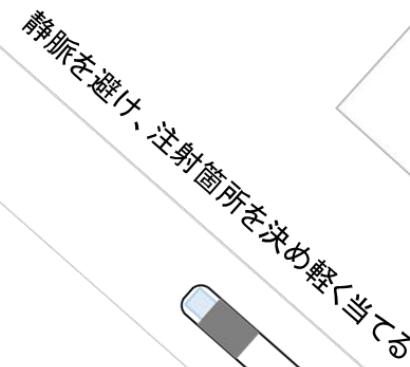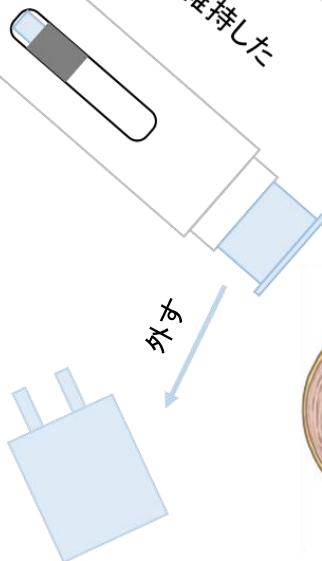

注入は1~2秒